



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

ENQUETE SSSH 2009

Résultats des hôpitaux suisses



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

Développement des Stérilisations centrales

- But du sondage
- Période couverte par le sondage
- Questionnaires envoyés
- Questionnaires renvoyés / remplis



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

Les 10 chapitres du sondage


- Etablissement
- Salaire + Formation et Compétences
- Transport
- Lavage et désinfection
- Emballage
- Stérilisation
- Réparation et stock
- Différents contrôles
- Documentation et traçabilité
- SSSH




Important!

- Limitations
 - nombre de questionnaires renvoyés
 - questionnaires non renvoyés et distorsion possible des résultats
 - questions et leur interprétation


Statut de l'établissement

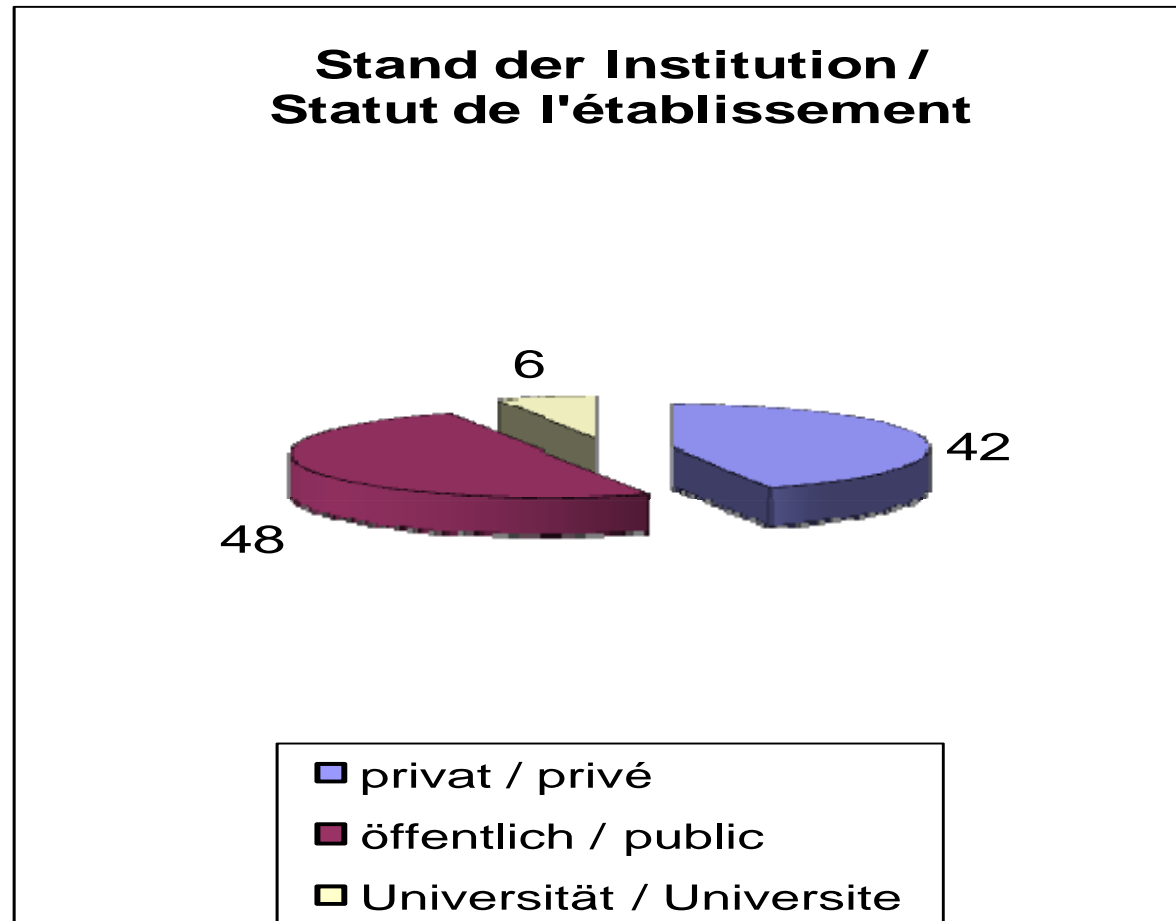


Nombre de lits

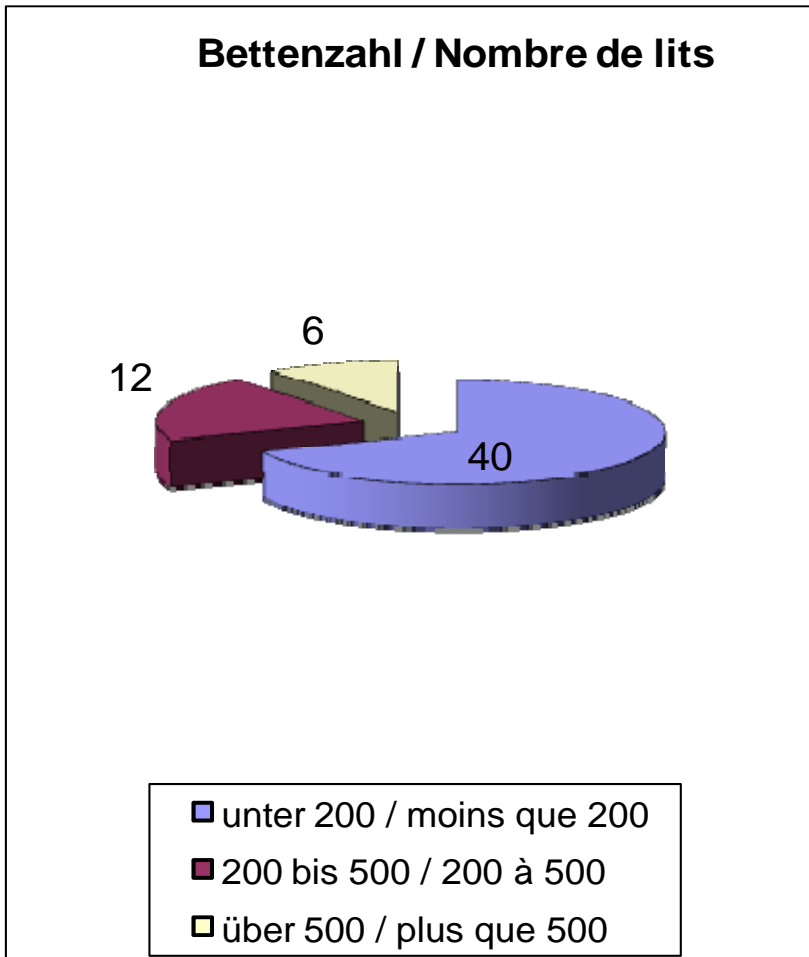


Quantité totale

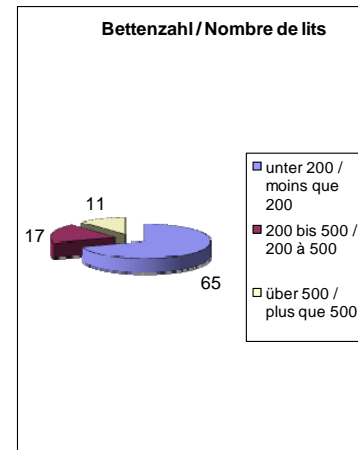

DE

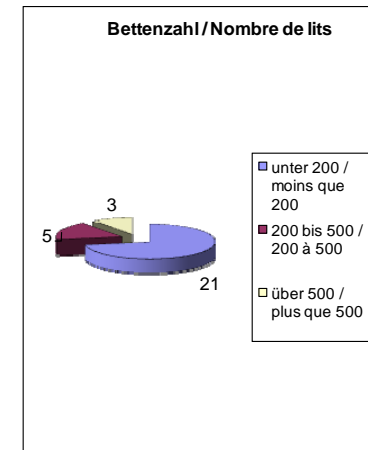


FR

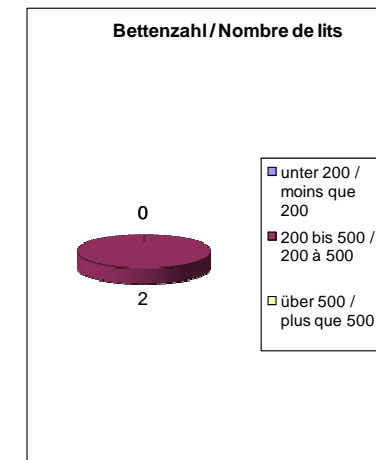


IT



Rattachement du service

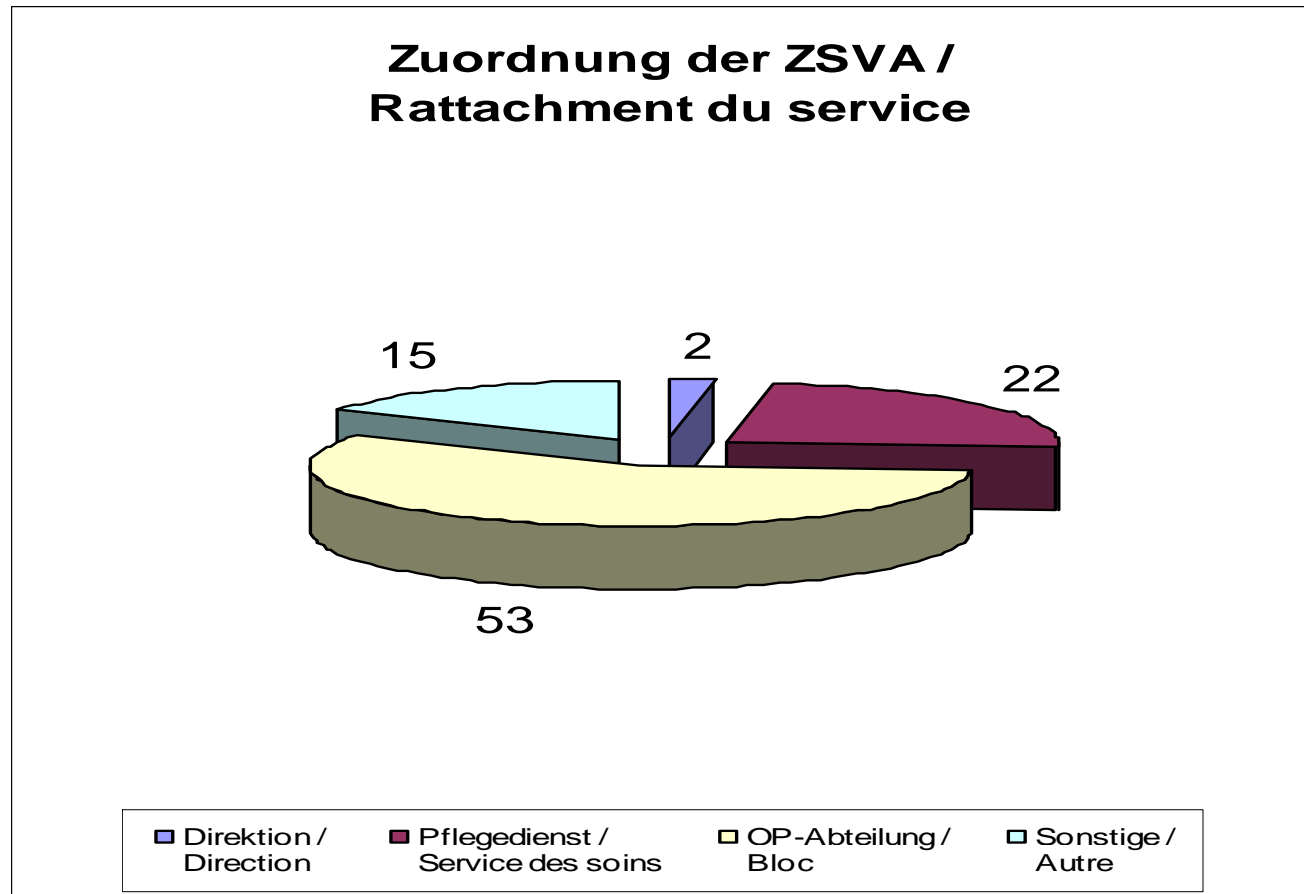


Formation du responsable

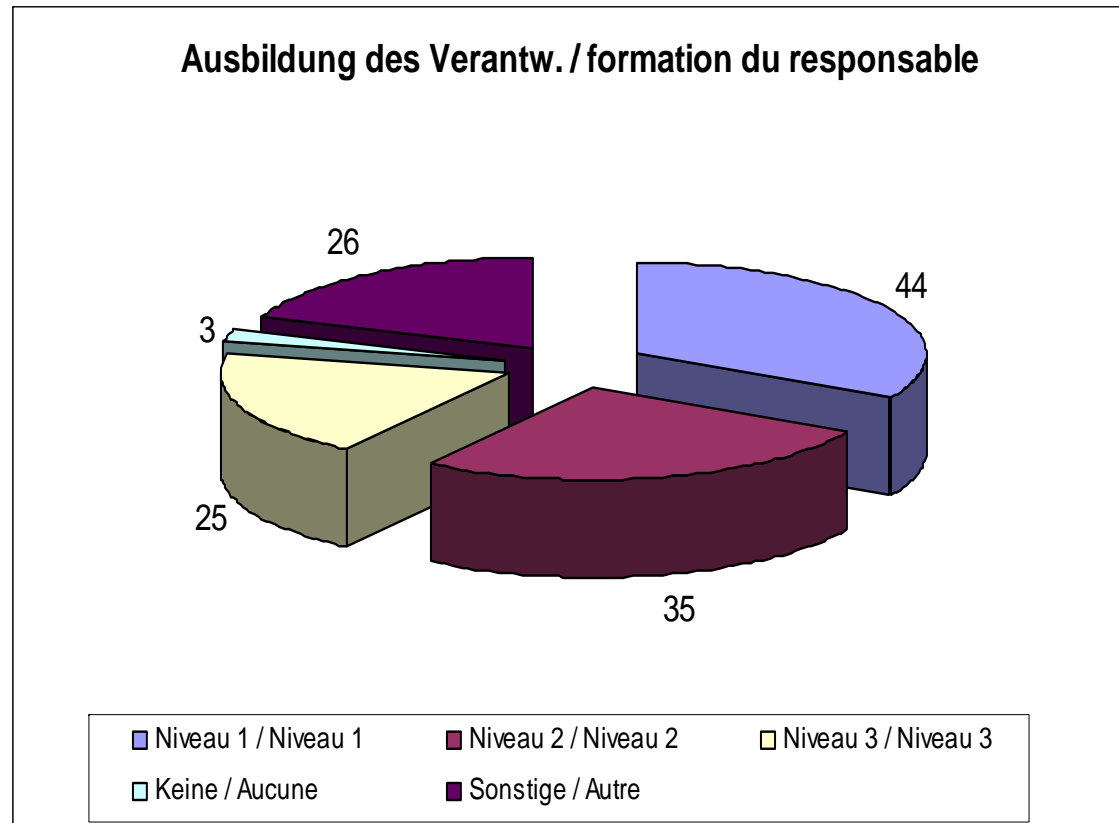





Certification du service

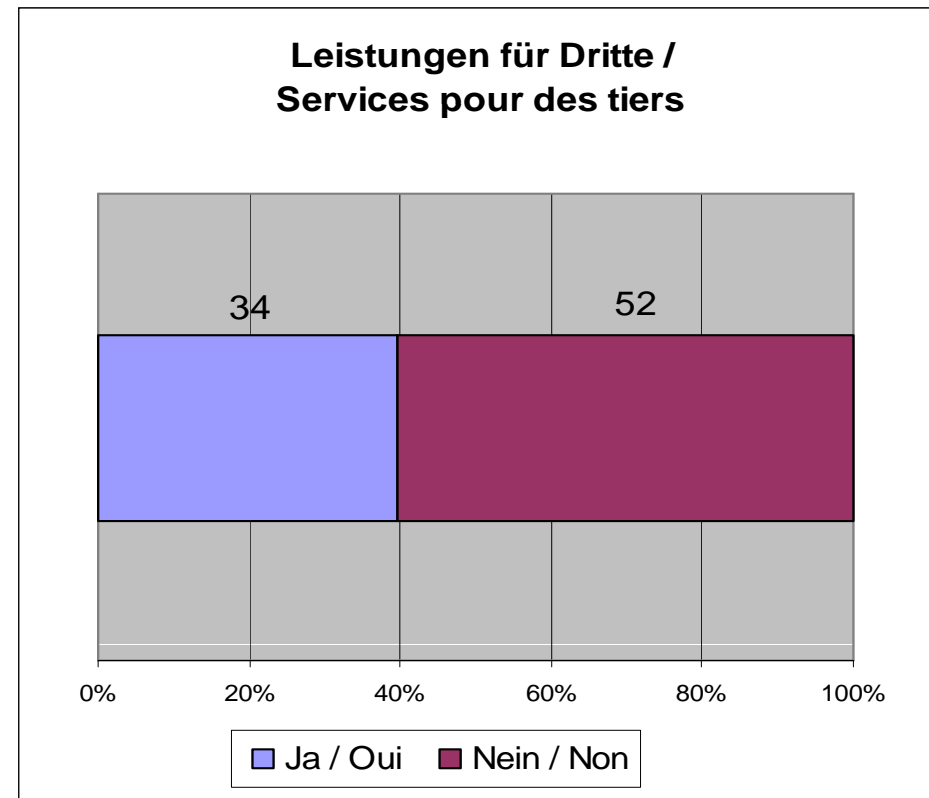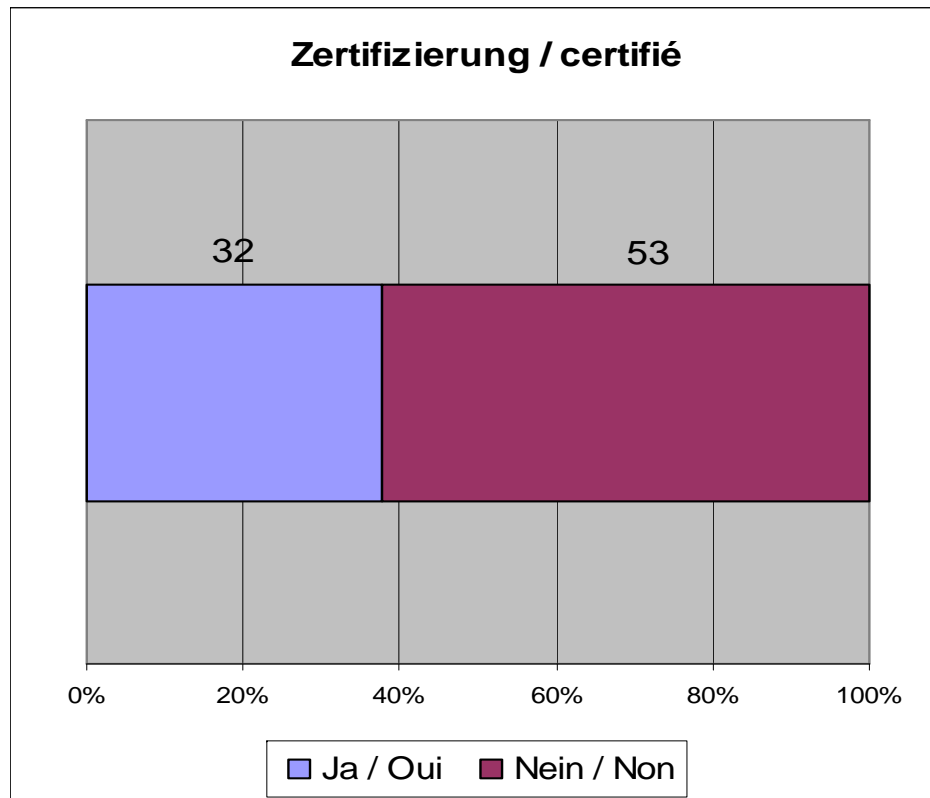


Formation des collaborateurs

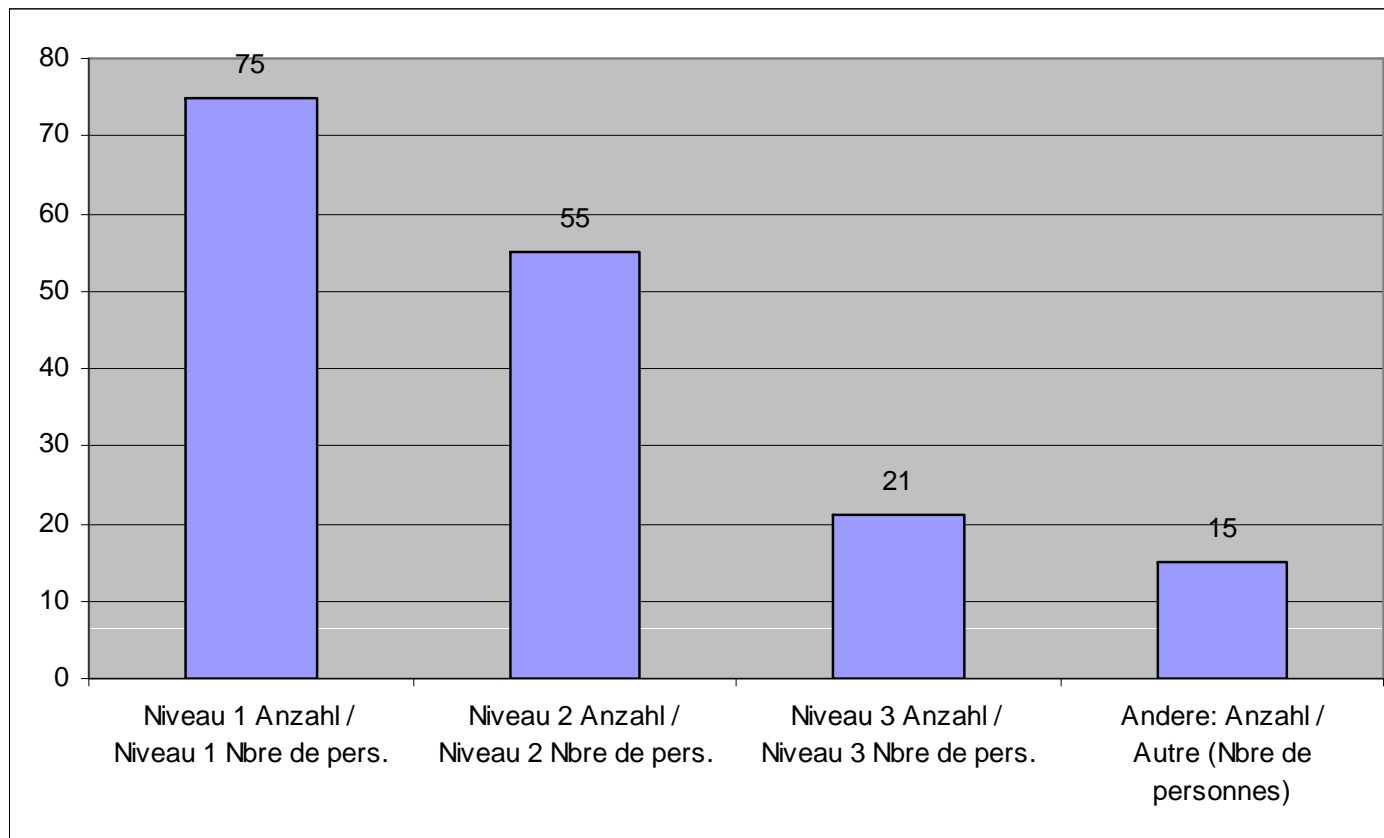


Salaire annuel brut

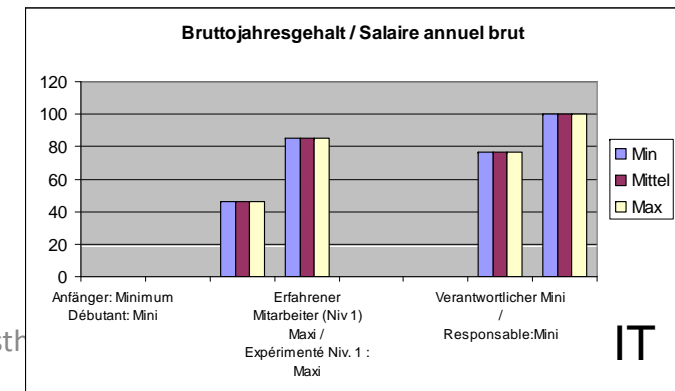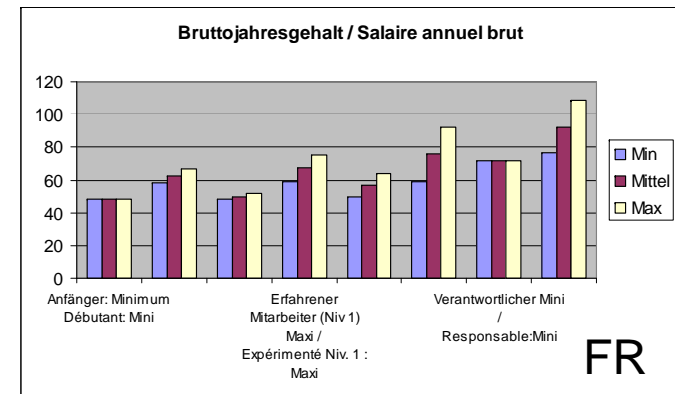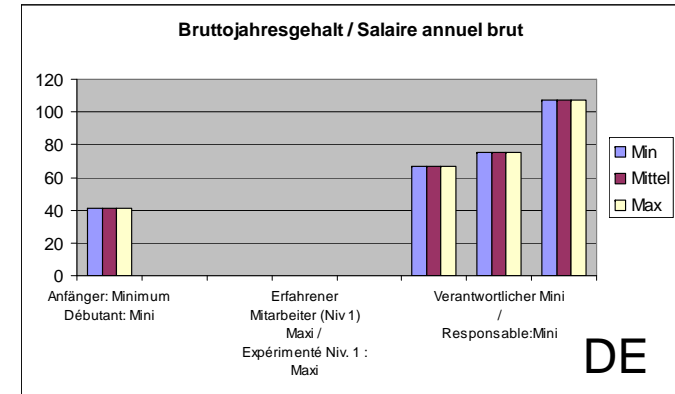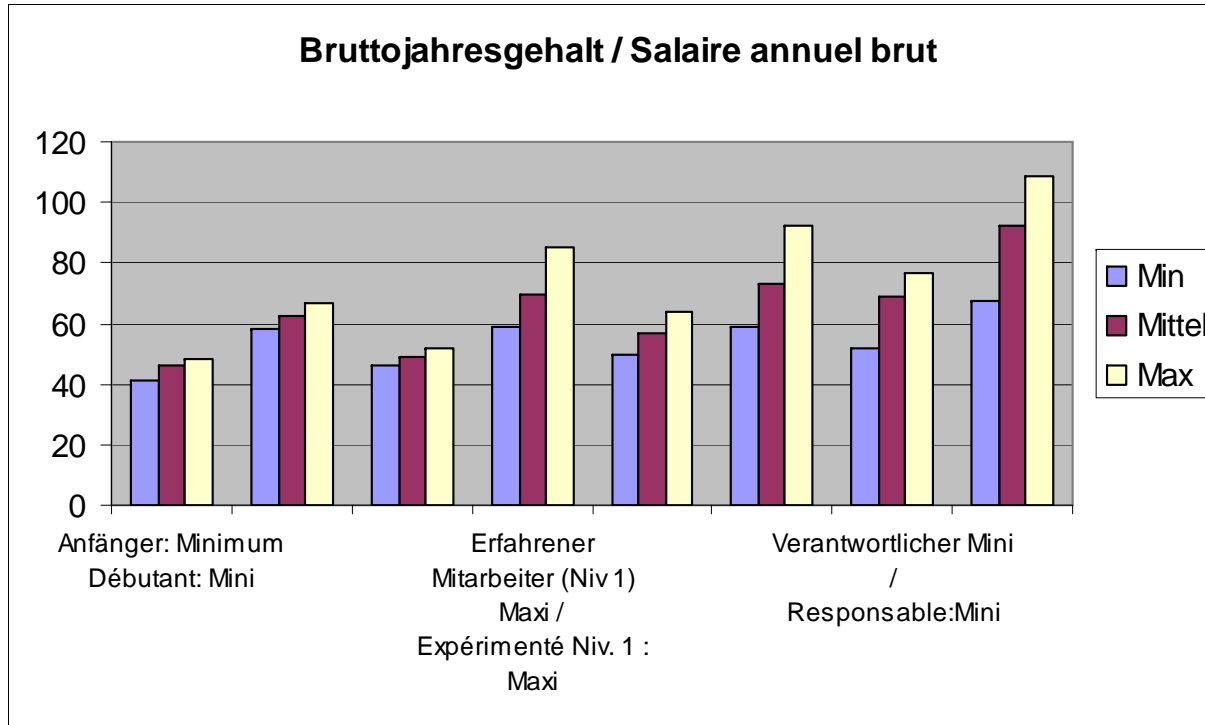



Implication du personnel du bloc dans le travail de la stérilisation

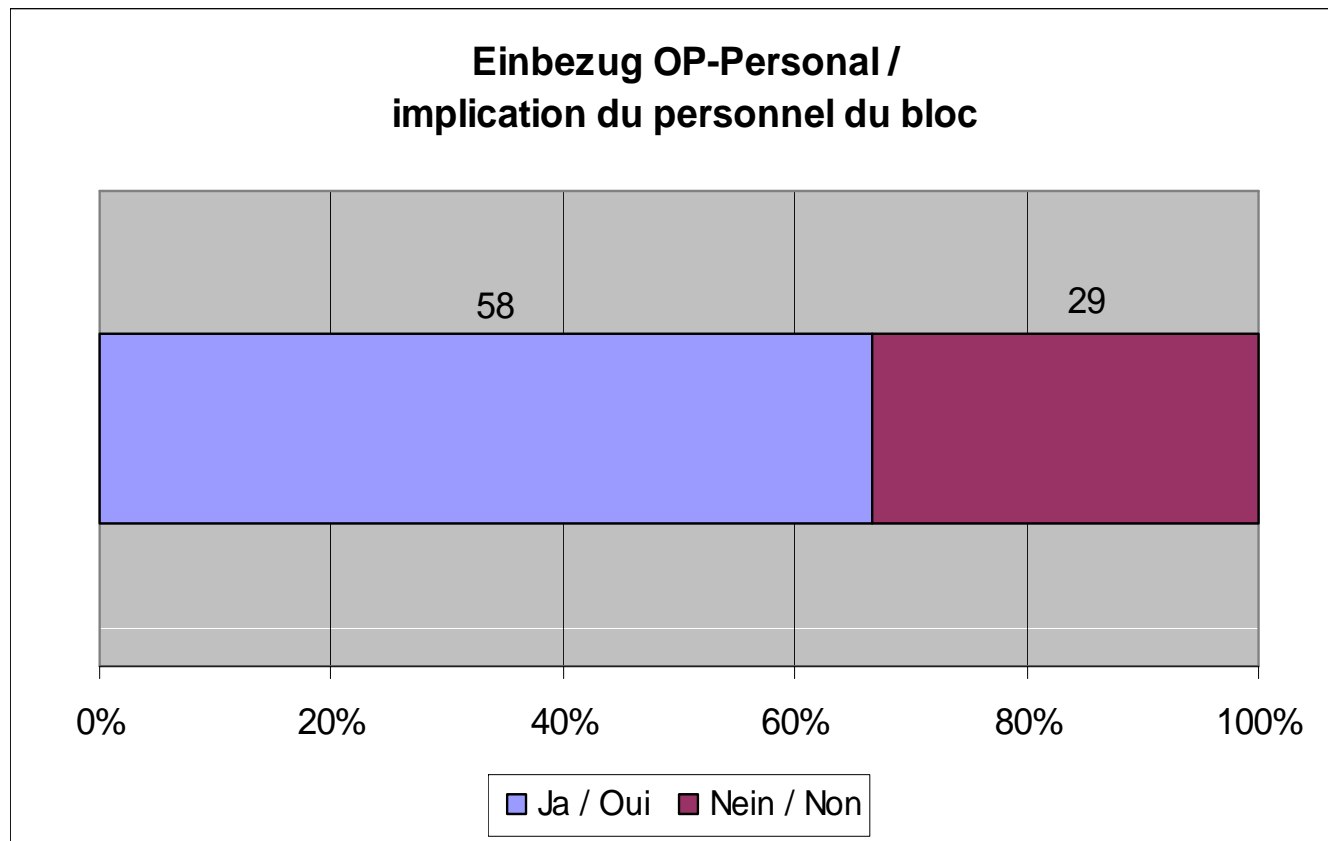

Une pré-désinfection est-elle effectuée?

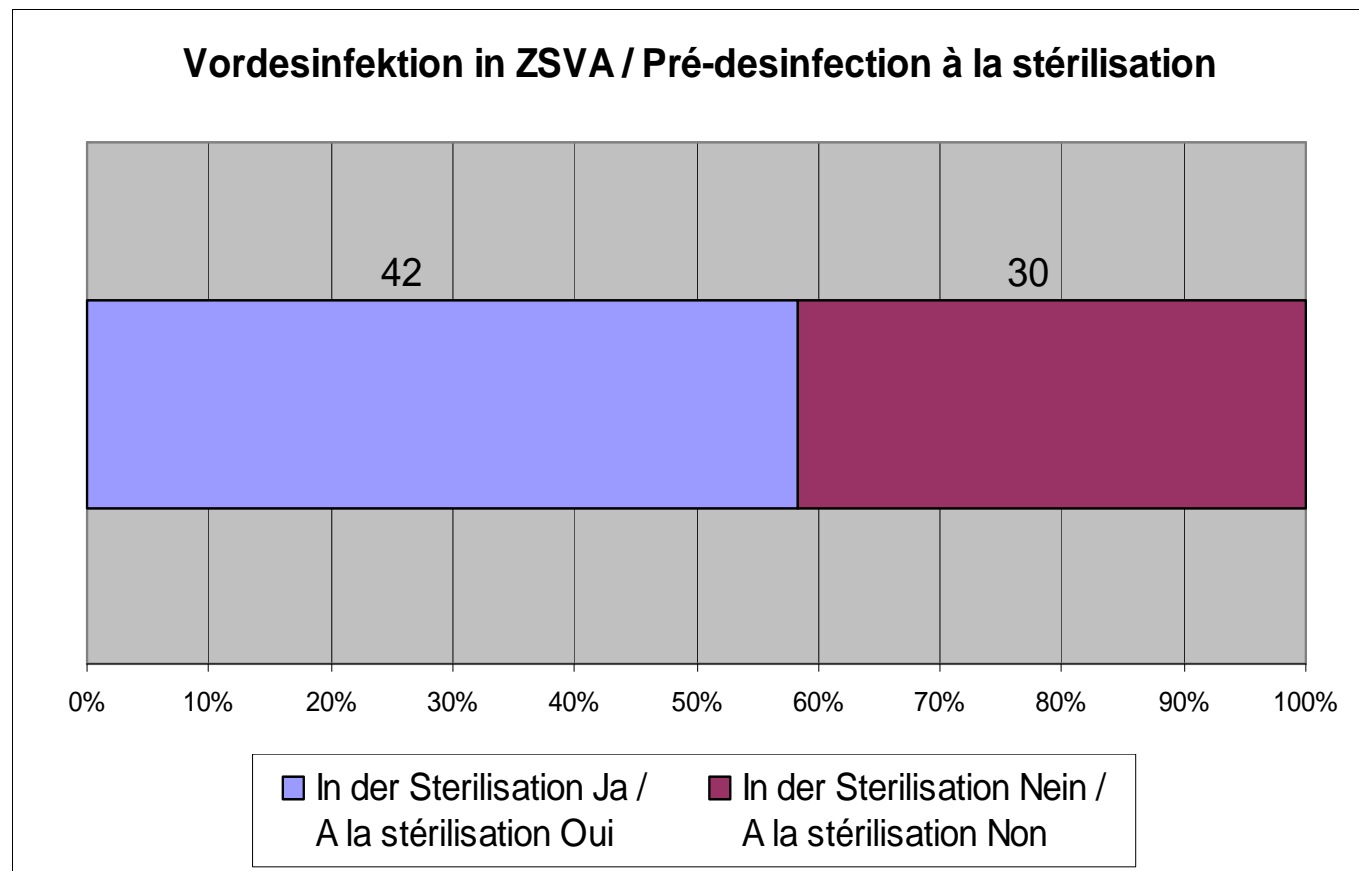


LD

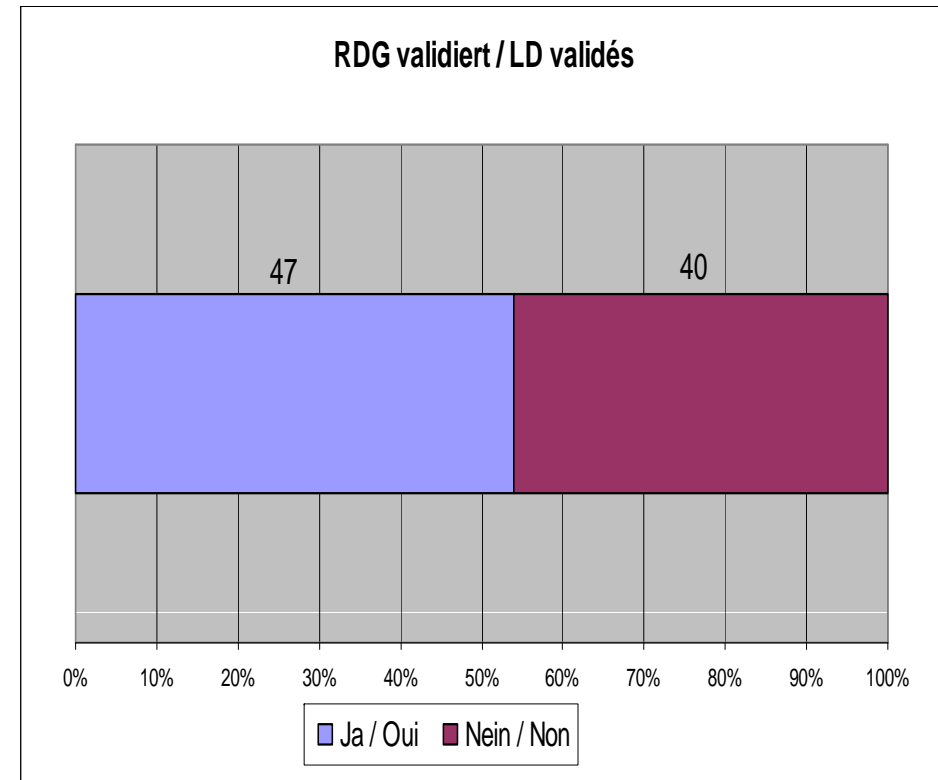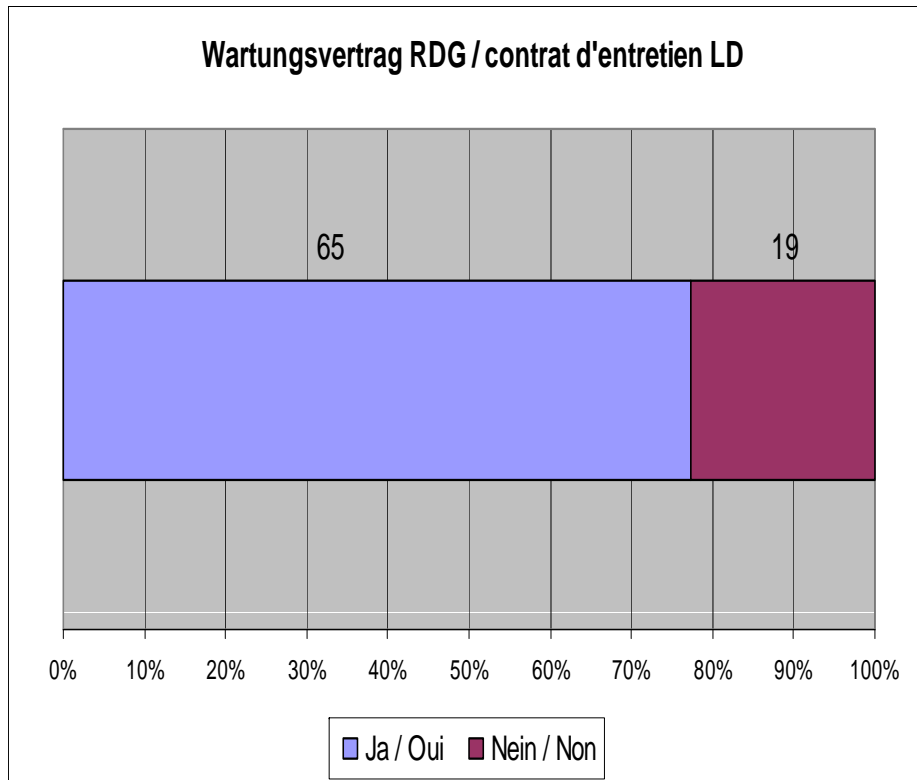


Possédez-vous des thermosoudeuses?

Anzahl Heissiegelgeräte / Nbr de thermosoudeurs

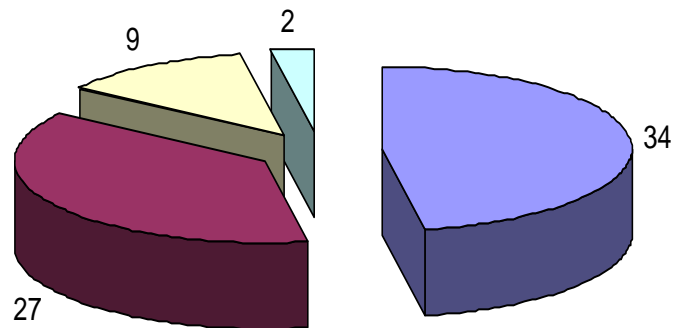

■ Anzahl 1 ■ Anzahl 2 ■ Anzahl 3 ■ Anzahl 4

Wartungsvertrag Heissiegelgeräte /
contrat d'entretien pour thermosoudeurs

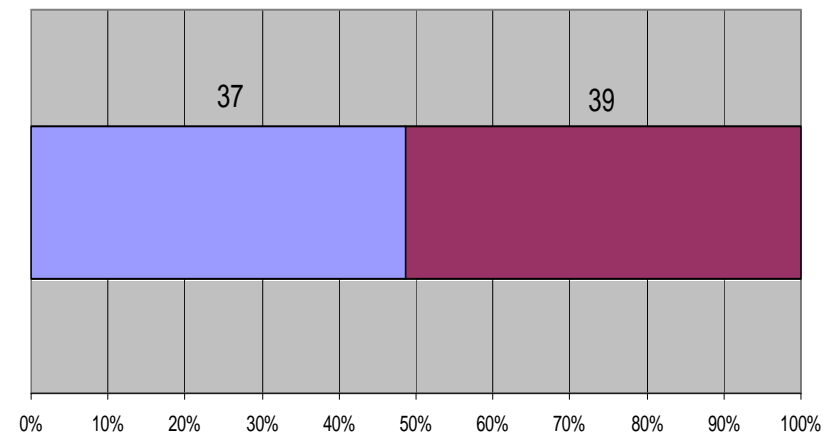


■ Wartungsvertrag Ja / Contrat entretien Oui ■ Wartungsvertrag Nein / Contrat entretien Non

Vue d'ensemble Modes de stérilisation


		Vapeur		OE		VH2O2		Formaldéhyde		Autres	
		Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Validation		75	94.94	4	57.14	26	92.86	0	0	2	3.17
Contrat d'entretien		68	87.18	6	100.00	21	80.77	0	0	?	?

Fréquence du test B&D (Bowie & Dick)

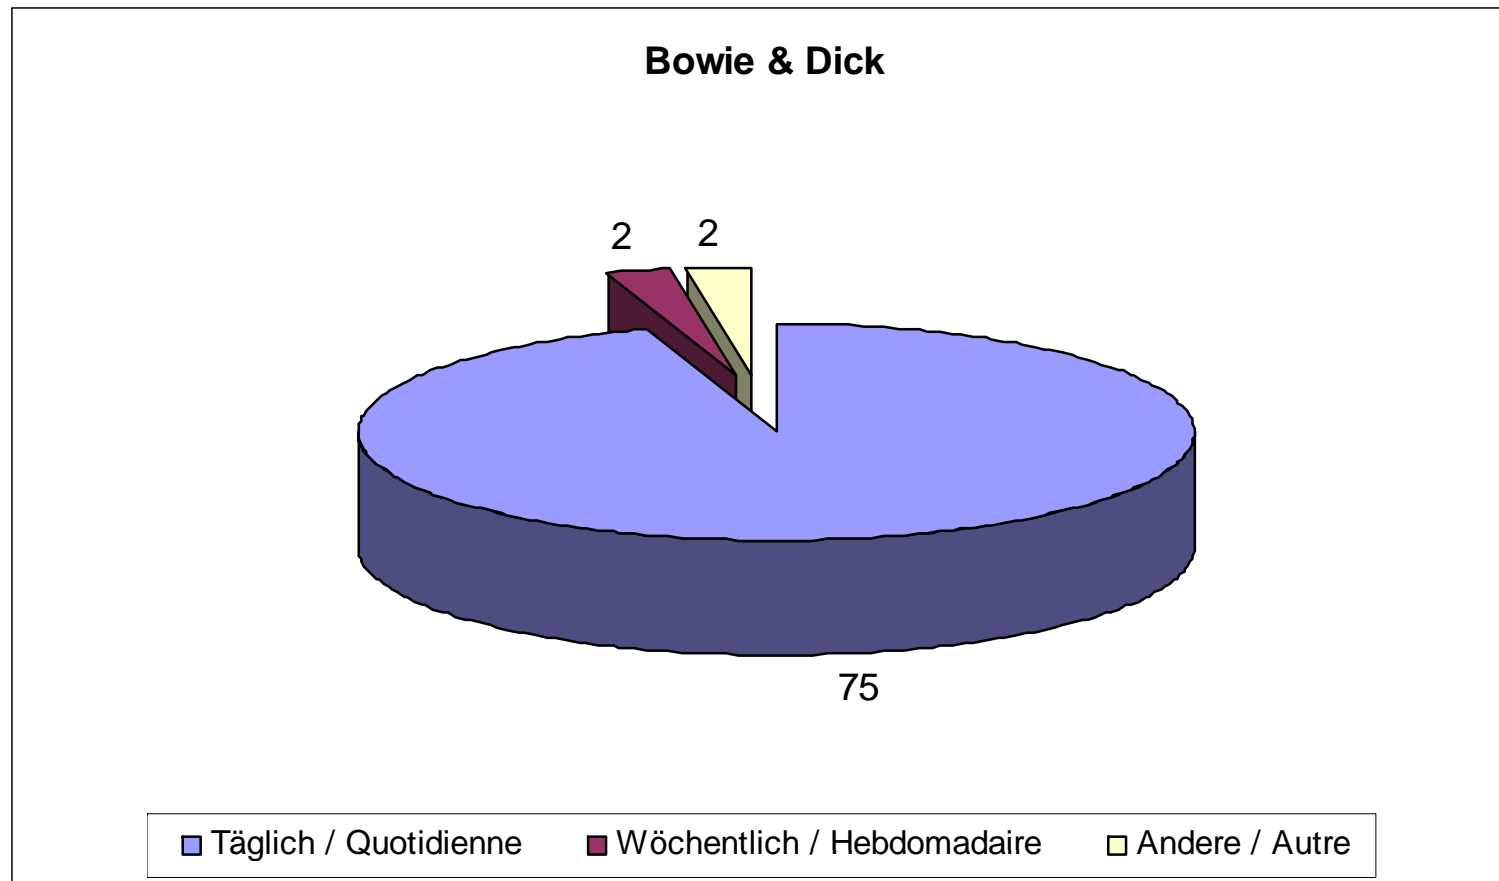


Stérilisateurs à vapeur


Validierte Dampfsterilisatoren /
stérilisateur à vapeur validés

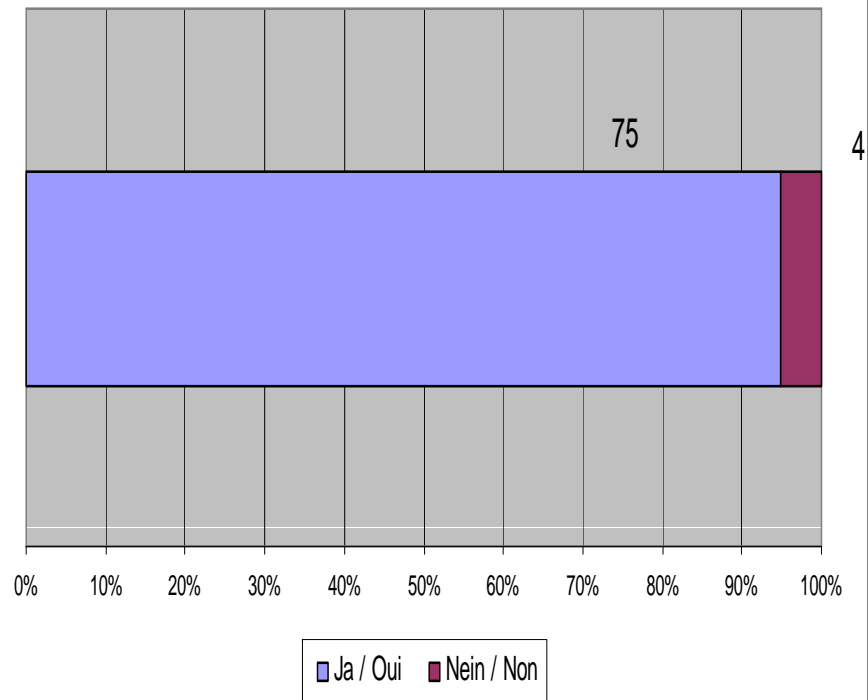





Wartungsvertrag Dampfsterilisator /
contrat d'entretien pour steri à vapeur

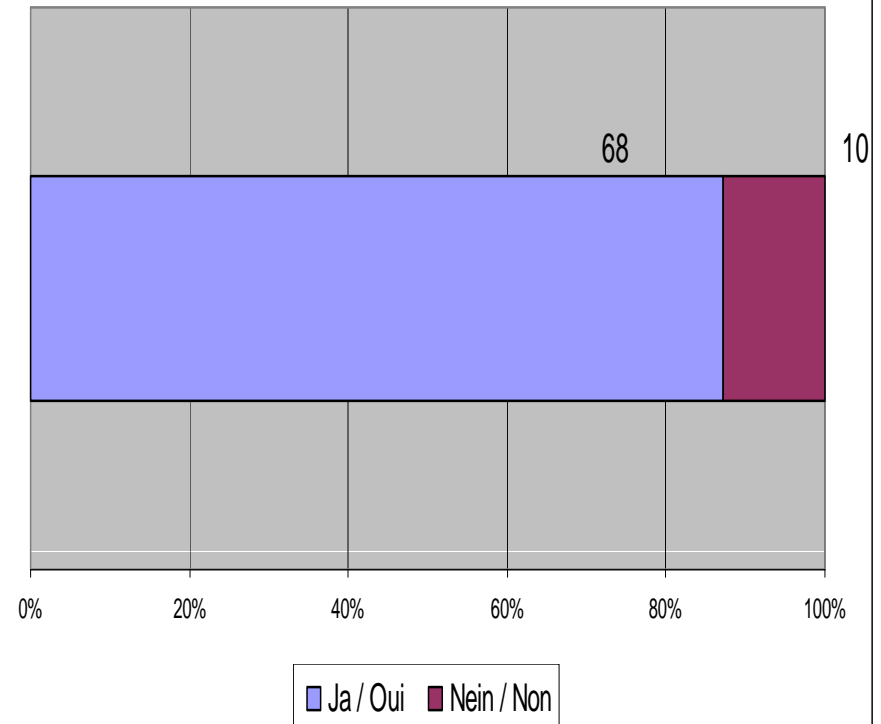




L'envoi d'un DM endommagé est faite par

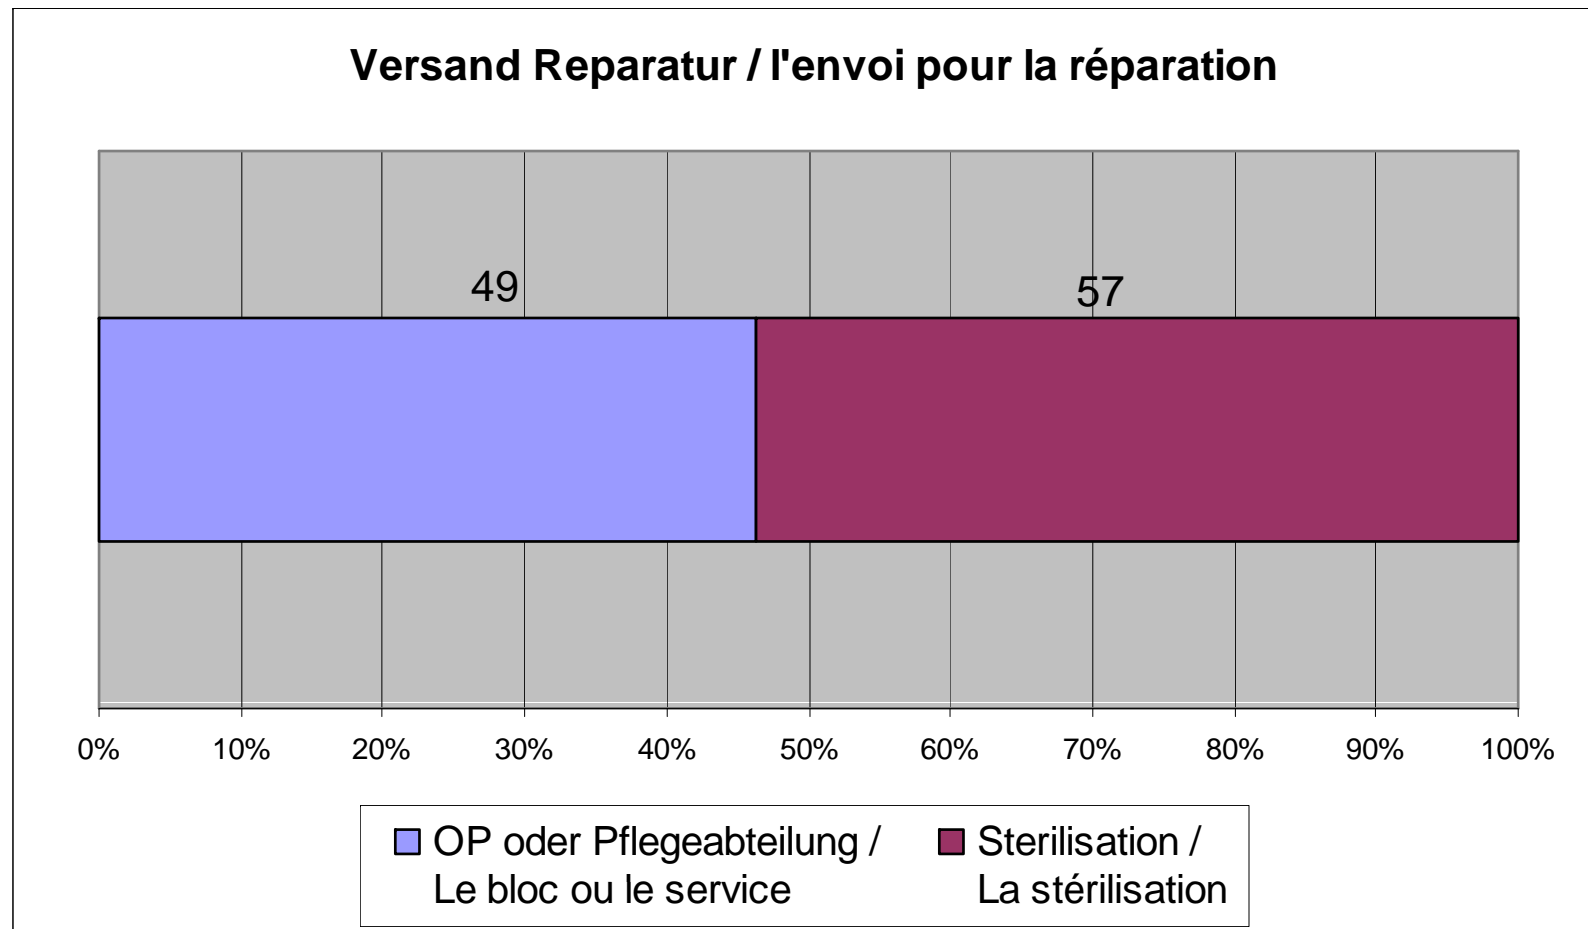

Différents contrôles

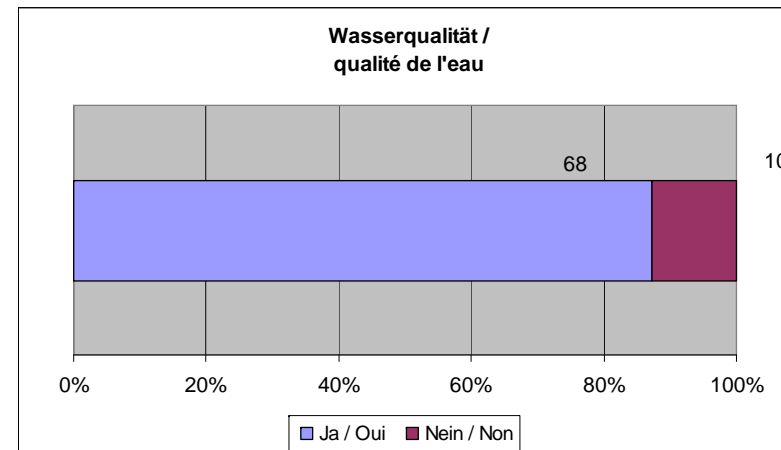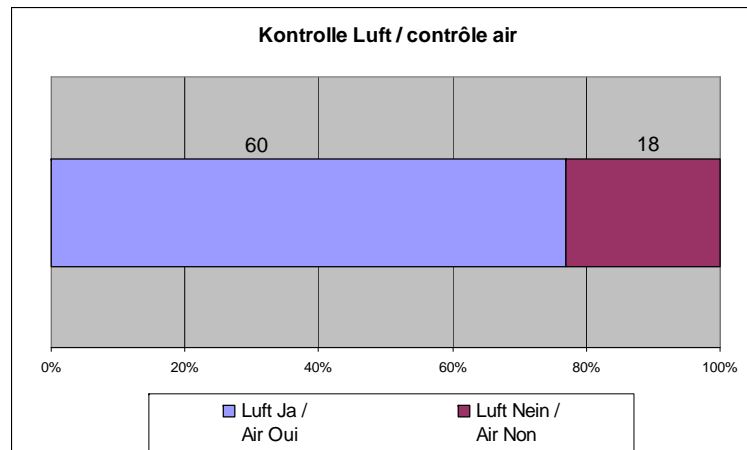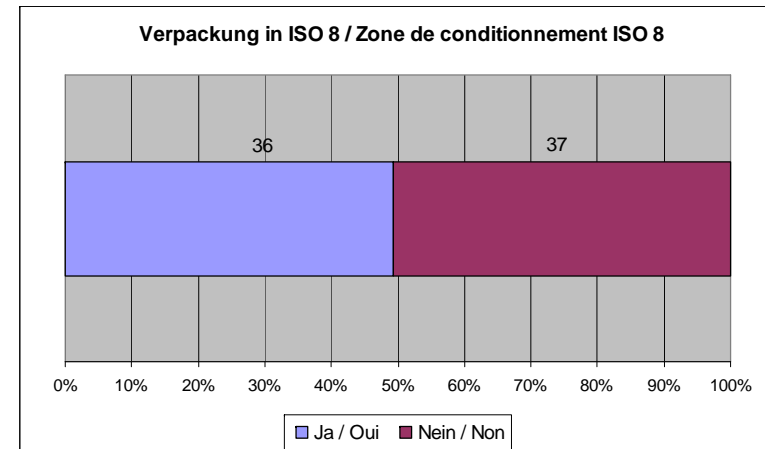
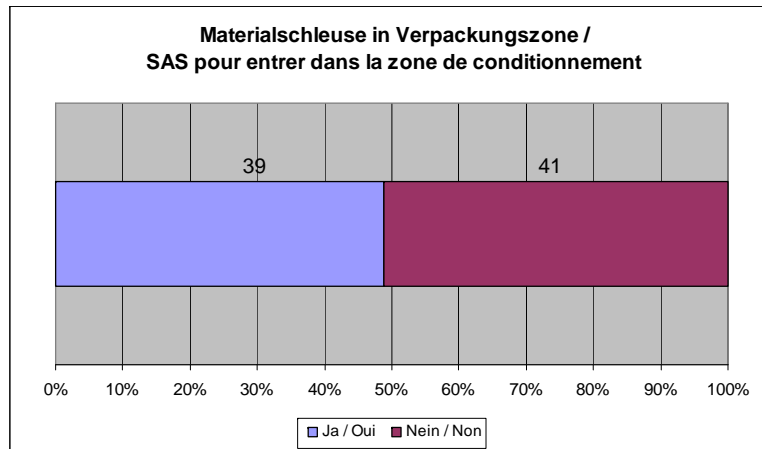


Documentation et traçabilité

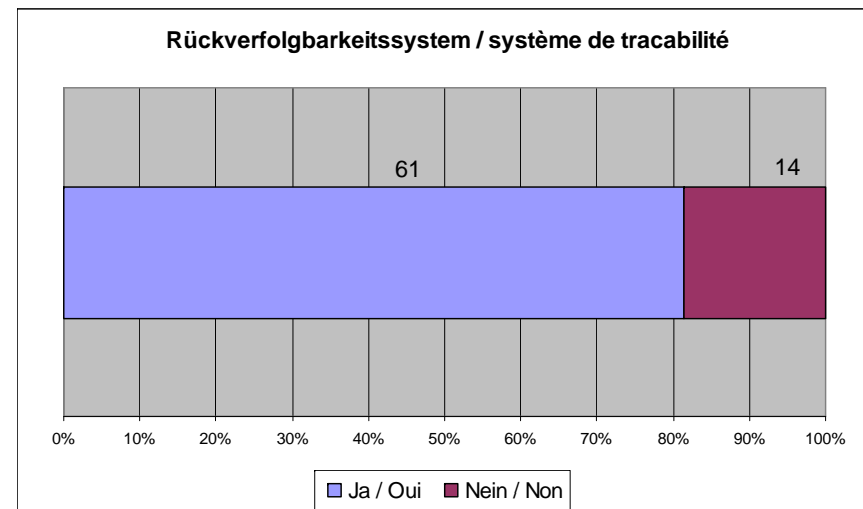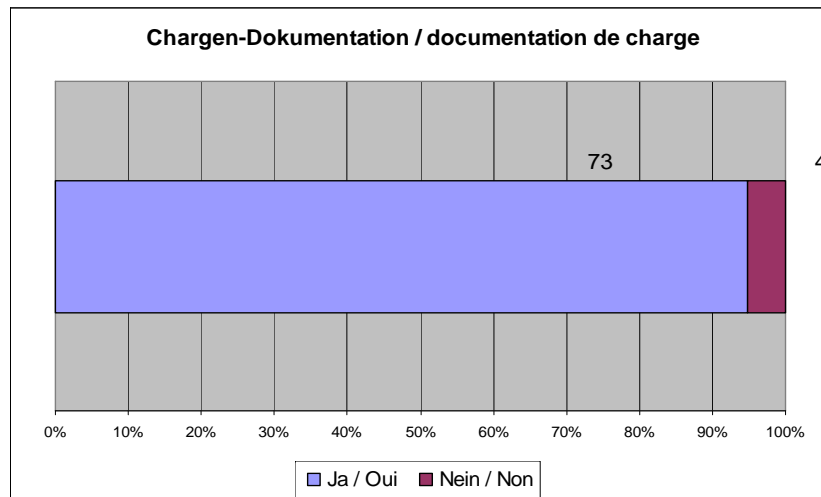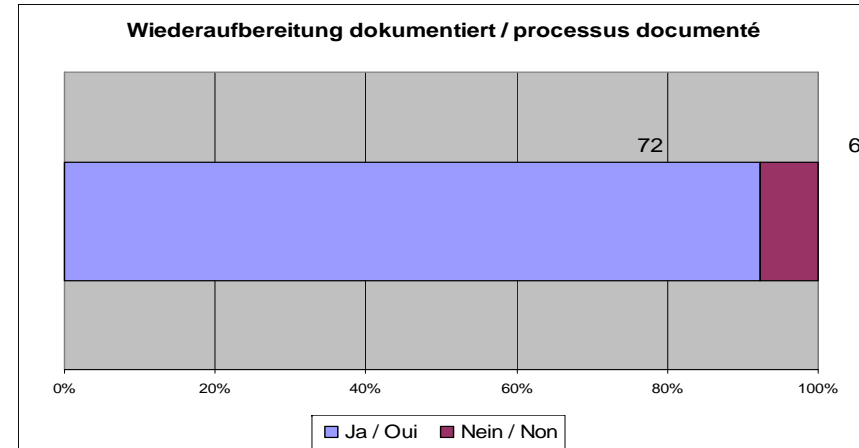



SGSV/ SSSH/ SSSO

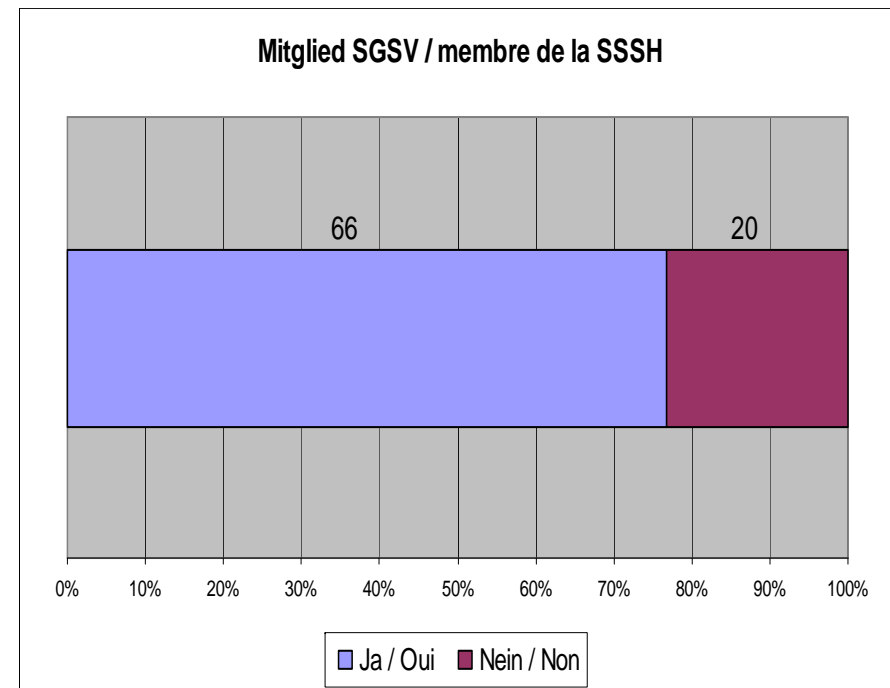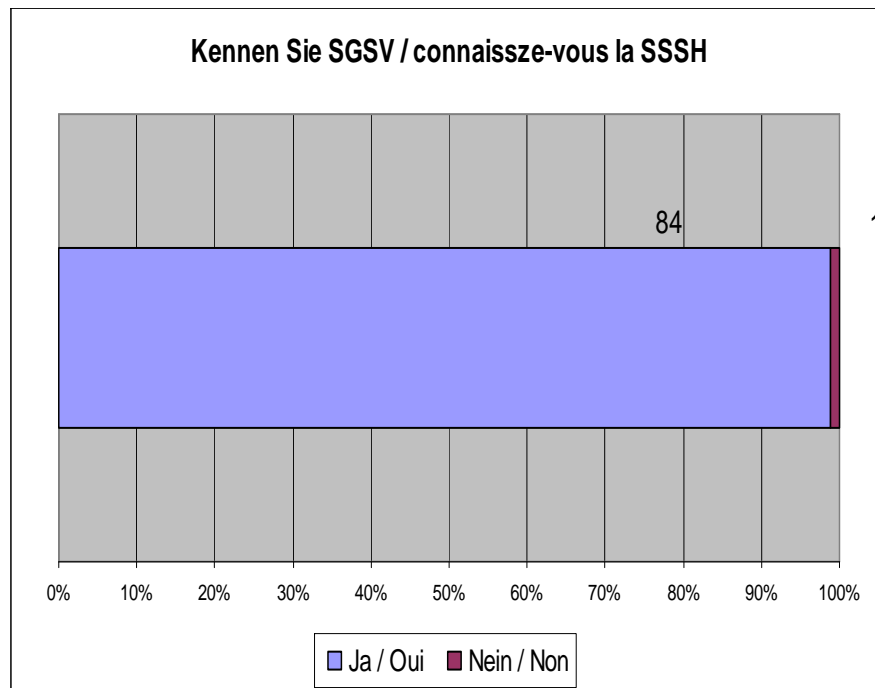



Autres approches possibles

- par région géographique
- par hôpitaux universitaires / cantonaux / de district (ou selon le nombre de lits)
- en fonction du genre de stérilisation



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

Et pour finir....

- Un grand merci à notre Président Frédy Cavin, qui s'est chargé de l'élaboration, de l'envoi et du premier dépouillement du questionnaire.
- Conséquences pour la SSSH?
- Questions?
- Merci de votre attention!

